

Sistema de preparación de muestras por Combustión para Cromatógrafos Iónicos – CIC



Sistema totalmente automatizado para la determinación y cuantificación de los diferentes halógenos (Flúor, Cloro, Bromo y Yodo) y Azufre en un solo análisis mediante la combustión y cuantificación por cromatografía iónica, para muestras sólidas, líquidas y gas/LPG.

**ASTM D7359; UOP 991; ASTM D5987;
ASTM D8150; ISO 19242; EN 17813**

AQF-5000H

Nuevo modelo

**ASTM D7359; ASTM D7994; ASTM D 8150;
UOP 991; UOP 1001**

AQF-2100V

**Configuración vertical
automatizable**



Contacto:

📞 934787161 – 913588879
✉️ info@nittoseiko.es
🌐 www.nittoseiko.es

Nittoseiko Analytech

Modelo AQF-2100V

Principales Características

- Rápido:** Inyección de muestra totalmente automática de líquido/GLP/gas.
- Preciso:** Obtención de valores de blanco más bajos, desde inyección directa de la muestra al sistema de combustión. Permite realizar inyecciones múltiples permitiendo llegar a concentraciones más bajas.
- Fácil:** No se requiere ningún programa de combustión. Al inyectar una muestra líquida en el sistema de combustión de forma segura, ya se puede operar con facilidad y seguridad.
- Medición múltiple de elementos (**F, Cl, Br y S**) mediante **una sola combustión**.
- Bajo impacto ambiental** debido a un menor consumo gases y eléctrico.
- Sistema de hidropirólisis:** El sistema de regulación de humedad mantiene la humedad constante en volúmenes elevados para mejorar la precisión de los análisis de flúor, cloro concentrado y bromo.
- Funcionamiento totalmente automatizado:** El uso del selector externo de calibración (opcional) junto con el automuestreador permite una medición totalmente automatizada de las curvas de calibración y las condiciones de combustión.
- Mantenimiento reducido:** La puerta frontal de la unidad de combustión proporciona acceso directo a los tubos de combustión del interior del horno eléctrico para su extracción y sustitución.



Opciones:

GI-260: Inyector de gases, líquidos volátiles y LPG.



CM-210: Sistema de control de combustión.

Contacto:

 934787161 – 913588879
 info@nittoseiko.es
 www.nittoseiko.es

Nittoseiko Analytech

Nuevo modelo AQF-5000H

Principales Características:

- Software fácil de usar.** Software de nuevo diseño con experiencia de usuario mejorada.
- Ánalysis en un amplio rango de concentraciones.** Tubo de absorción de nuevo diseño para facilitar el cambio entre aplicaciones en un amplio rango de concentraciones. Manejo avanzado de líquidos con posibilidad de análisis múltiples con diferentes diluciones a partir de una combustión/absorción. Colector de muestras adicional para almacenamiento y análisis posteriores.
- Diseño de opciones enchufables.** Las unidades opcionales pueden integrarse directamente en la unidad de absorción.
- Comutación de dos soluciones de absorción.** Comutación automatizada entre aplicaciones que requieren agua pura o que requieren aditivos.
- Combustión fácil, segura y repetible.** Programas de combustión fácilmente personalizables que proporcionan una combustión fiable con recuperación total.
- Análisis de alta sensibilidad y precisión.**
- Fácil mantenimiento.**
- Funcionamiento en paralelo para un alto rendimiento.** El funcionamiento en paralelo de la preparación de muestras (combustión) y la cromatografía iónica (cuantificación) permite tiempos de ciclo rápidos y aumenta el rendimiento de las muestras (o el número de réplicas).



Opciones:

ASC-570LS: Cambiador automático de muestras para muestras sólidas y líquidas.

- Sólido: 49 posiciones
- Líquido: 84 posiciones (vial de 4 ml), 120 posiciones (vial de 2 ml)



ABC-500: Inyector naveccilla automático.




Contacto:

- 📞 934787161 – 913588879
✉ info@nittoseiko.es
🌐 www.nittoseiko.es



Nittoseiko Analytech

Principio de medida

Después de la digestión térmica de las muestras en una atmósfera de Ar, se produce la combustión con oxígeno y agua. El azufre de las muestras se transforma a óxidos de azufre (SO_X) y los halógenos a haluros de hidrógeno y gas halógeno. Estos elementos son atrapados por la solución absorbente y posteriormente inyectada al Cromatógrafo iónico.



Flujo de proceso

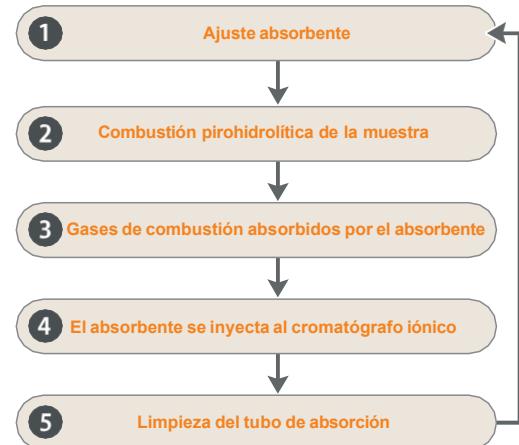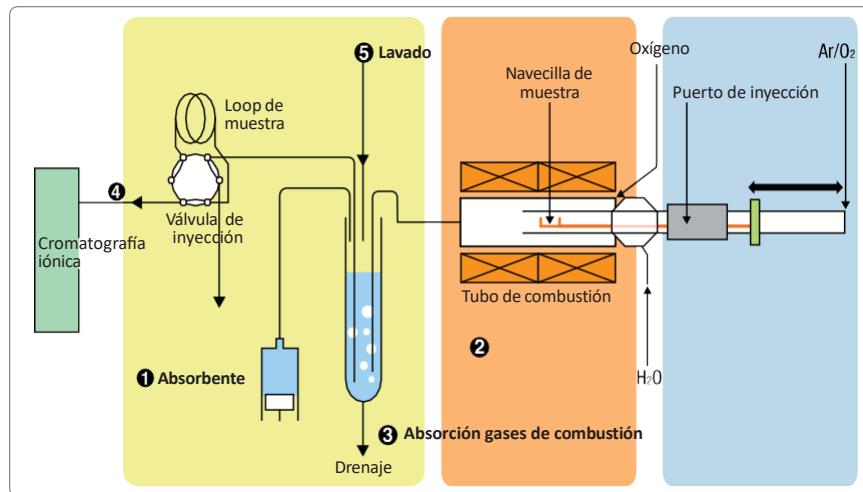

Contacto:

934787161 – 913588879
info@nittoseiko.es
www.nittoseiko.es